

盐城市药品（医用耗材）集中采购工作领导小组办公室文件

盐药采办〔2019〕2号

盐城市药品（医用耗材）集中采购工作领导小组办公室 关于做好盐城市医疗卫生机构医用耗材及试剂 备案采购工作的通知

各县（市、区）医疗保障局，盐城经济技术开发区人力资源和社会保障局，盐南高新区社会事务管理局，市公立医疗卫生机构：

近期，市药品（医用耗材）集中采购工作领导小组办公室印发了《盐城市医疗卫生机构医用耗材及试剂备案采购实施办法》。为有序推进备案采购工作，现将有关事项通知如下：

一、医疗卫生机构对照《盐城市医疗卫生机构医用耗材及试剂备案采购实施办法》中“适用条件”第1条和第2条，登录耗材备案采购系统，申报所需备案产品。网址：<http://61.155.5.45/dshcba>，操作手册见附件1。

二、医疗卫生机构对照《盐城市医疗卫生机构医用耗材及试剂备案采购实施办法》中“适用条件”第3条，登录盐城市医用耗材平台，申报所需备案产品。网址 <http://61.155.5.40/ycpricecoll/>，操作手册见附件2。

三、申报起止时间为：9月22日上午9:00—9月26日下午18:00。

- 附件：1. 适用条件1、2产品填报操作手册
2. 适用条件3产品填报操作手册

盐城市药品（医用耗材）
集中采购工作领导小组办公室
2019年9月20日

附件 1

适用条件 1、2 产品填报操作手册

1. 注意事项

①浏览器设置请看操作手册最下面。

②用 IE 浏览器，IE6-IE10 版本浏览器，备案申请表为 JPG 格式，图片不得大于 800K。

③申报系统只能选择《备案采购实施办法》里面备案申请条件 1 和备案申请条件 2。

④系统填报相关产品信息，一定按照注册证上面填写，如果无注册证，按照备案凭证或者说明书填写，填报的供应价格与填报单位相对应。

⑤系统中带有*的为必填项，如无相关信息的，就填写“无”。


⑥新增成功产品状态为“准备”，最终填报完成的状态为“发送”，请检查一下最终状态，以防遗漏申报产品。

2. 用账号密码登录网址：<http://61.155.5.45/dshcba> 显示界面：江苏省地市耗材备案采购系统，首先输入医疗机构用户名和密码，然后点击【登录】按钮，如下图：

江苏省地市耗材备案采购系统



3. 点击主菜单栏【耗材备案采购】按钮下【申请备案采购耗材】，如图：

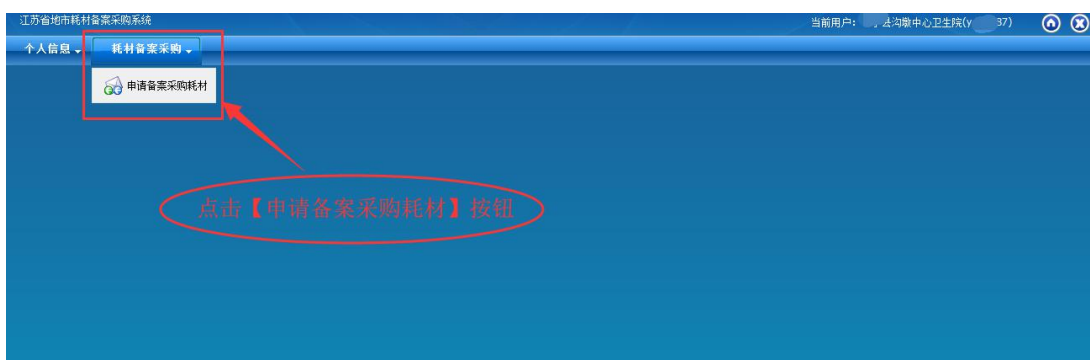




4. 点击【备案申请】按钮，出现备案采购新增、发送、删除、导出产品功能的界面，如图：



5. 点击【增加】按钮，出现增加产品名称、规格、型号、材质、单位、注册证号、供货价格等相关信息，备案采购附件为：jpg 格式，图片不得大于 800k。标有*的为必填项,填写好相关信息和上传盐城市备案采购申请表附件，点击【保存】按钮，弹出一个确定对话框，点击【确定】按钮。（备注：填写的相关信息一定按照产品注册证上面填写，填写的供货价格一定与单位相对

应，必填项*无相关内容应填写：无)

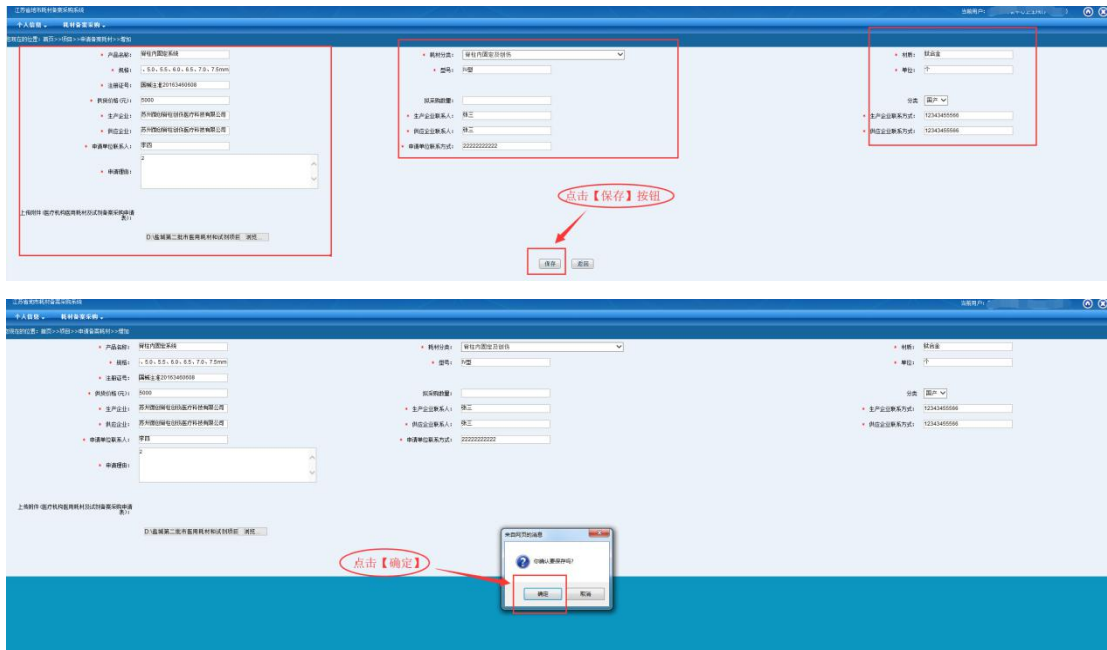

5. 确定填写的相关信息和上传备案采购附件，弹出：新增成功栏框，同时能看到增加成功的产品信息。



6. 点击【查看】功能，显示出已经填写好的相关信息和备案申请表附件，状态是：准备，如果增加多条产品，继续点击【新增】按钮，填写相关内容和上传附件，如图：



7. 在新增成功的产品后面方框内打√，然后点击【发送】按钮，然后跳出：确定要发送所选择的记录，点击【确认】。



8. 提示：发送成功，状态变为：发送，说明这一条产品申报备案成功。



9. 在产品新增成功，状态是：准备的情况下，如果需要修改已填好的相关内容或者删除这一条记录，请在这一条产品后面打√，点击【删除】按钮，然后确定删除，提示：删除成功，该删除产品记录不在系统中出现。



10. 在产品主页下面有【导出】功能，可以填报的产品信息以表格的形式导出。在标题状态栏可以查询：准备、发送两个状态，以便查看是否备案产品填报成功。




IE 浏览器设置


一、 打开浏览器，点击工具—Internet 选项 (如下图所示)




二、选择标签里的安全，选择受信任的站点，点击站点按钮。
(如下图所示)

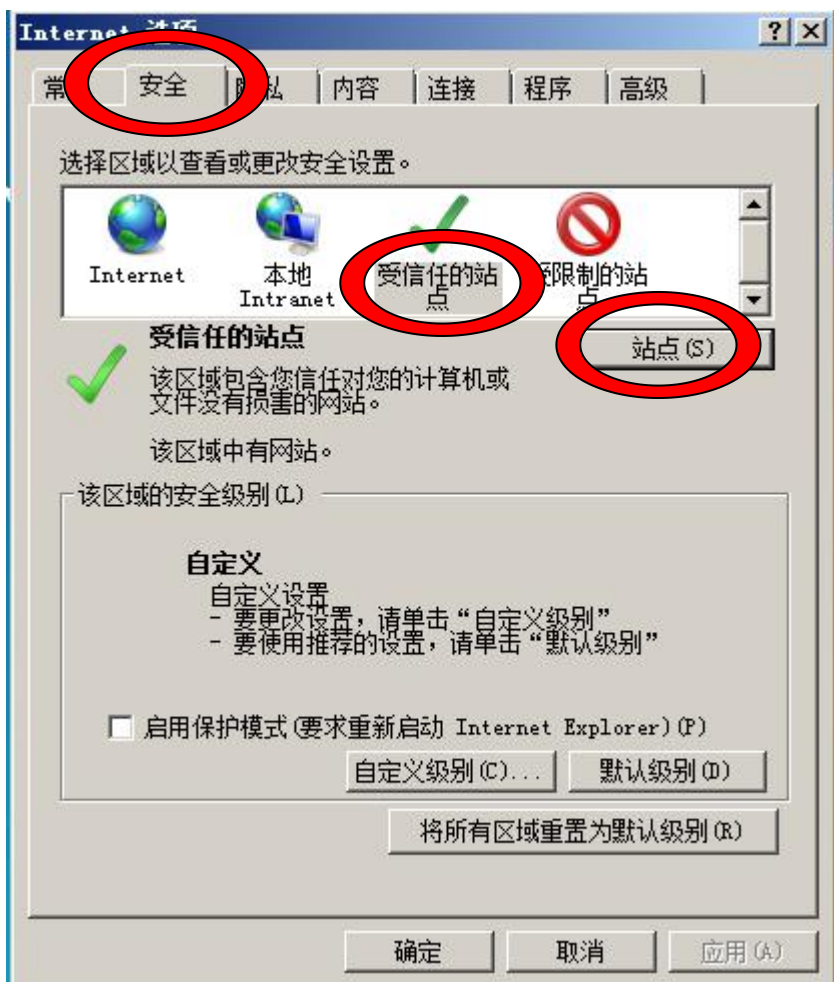

三、弹出受信任的站点对话框，在文本框中输入 <http://61.155.5.40/>，点击添加，这里注意下面的勾不能勾选(如下图所示)。关闭对话框。

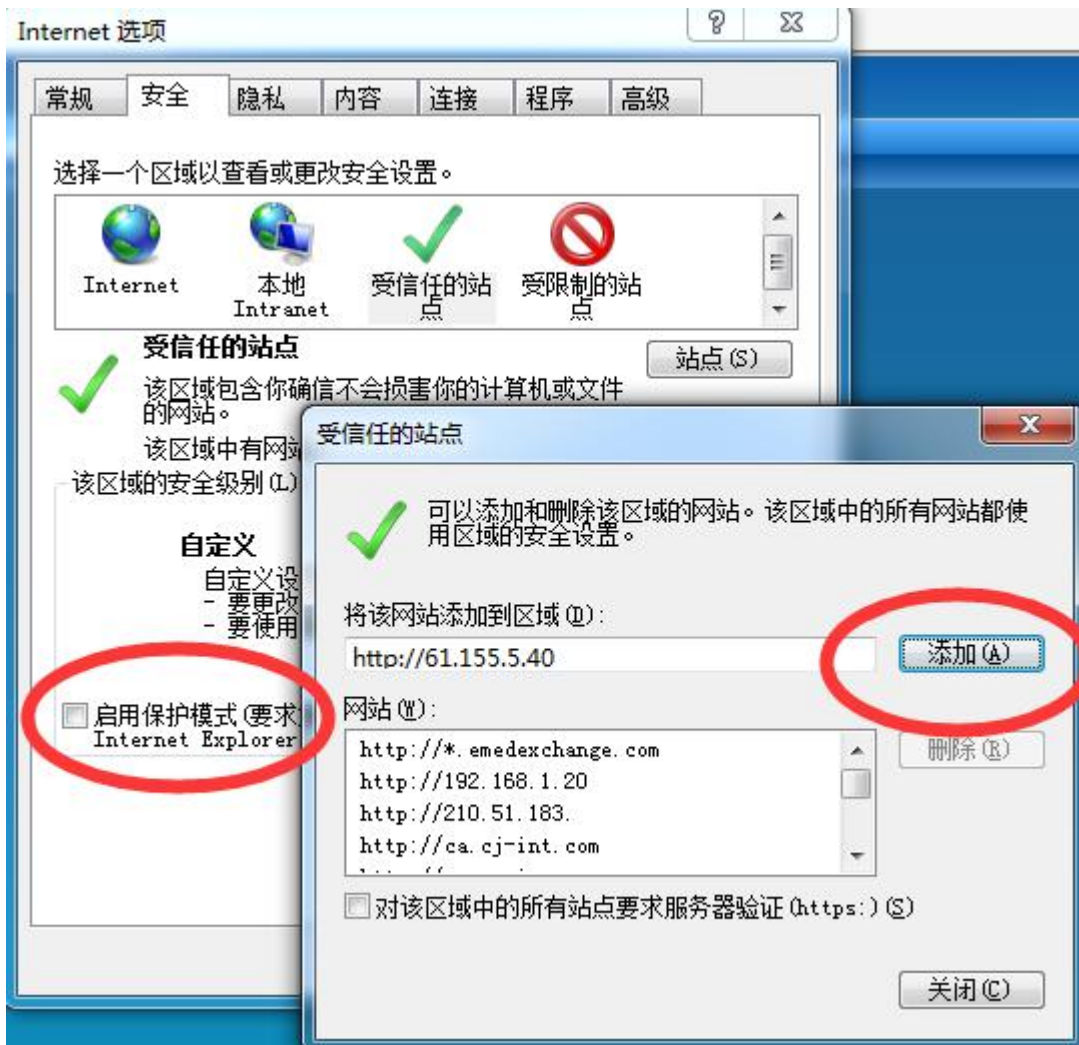


四、点击 Internet 选项对话框上的自定义级别按钮，弹出安全设置对话框，把带有 activex 的选项都设为启用。点击确定按钮保存修改。关闭所有对话框。把所有浏览器关闭。重新打开即可

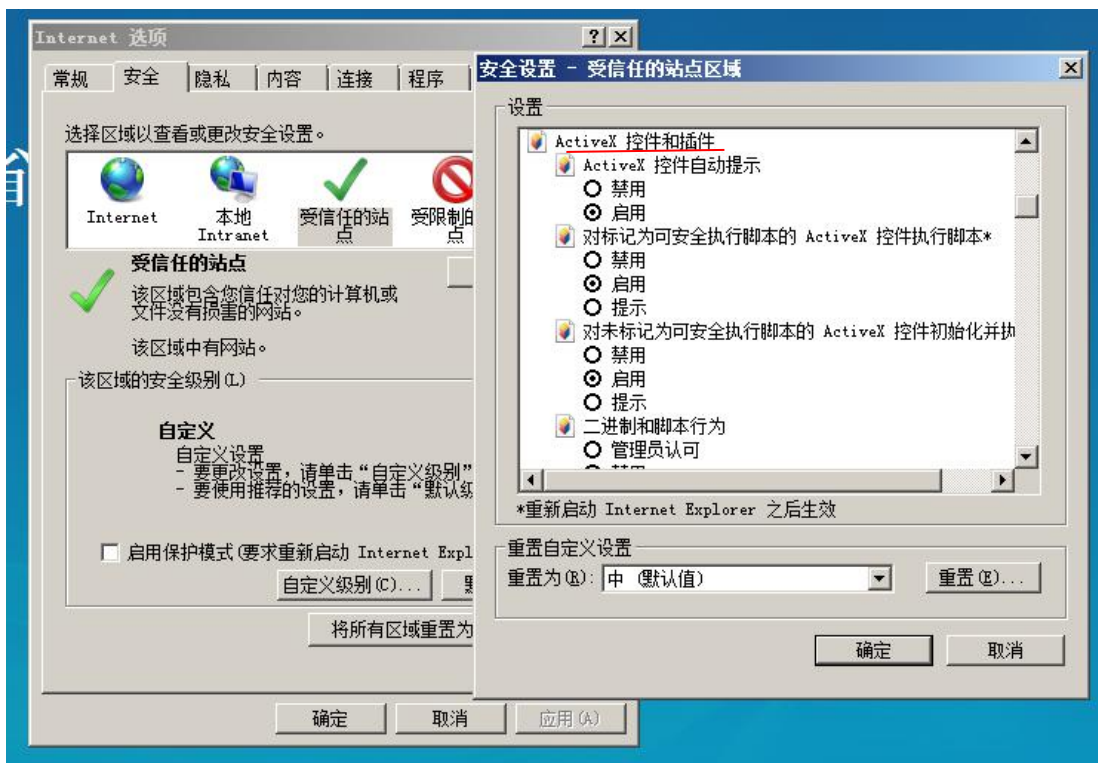

IE 兼容性视图设置

对于 IE 版本超过 6 的浏览器，需要设置兼容性视图。不设置会导致页面显示混乱。


1. 在 IE 的地址栏下的灰色空白区域右击鼠标，弹出菜单，“菜单栏”勾选上，然后在地址栏下面就会显示相关的菜单。

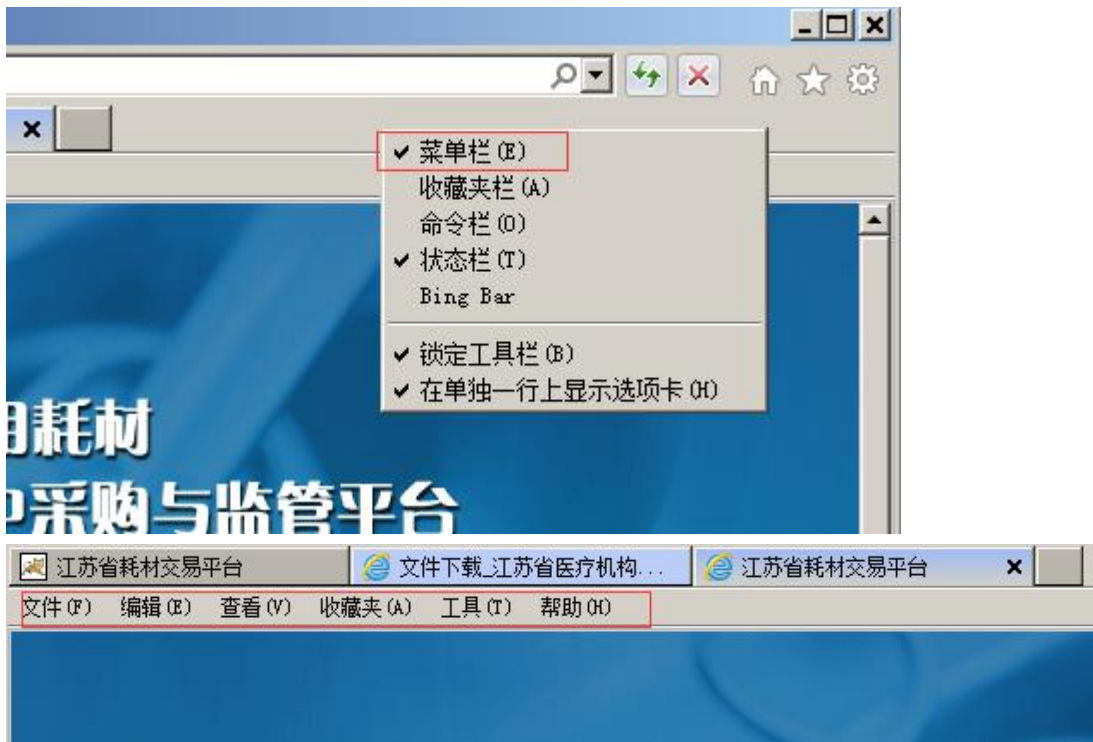


2. 点击菜单“工具”，选择菜单“兼容性视图设置”，如下图



3. 弹出框如下图，点击按钮“添加”把当前的地址添加到下面的列表中。

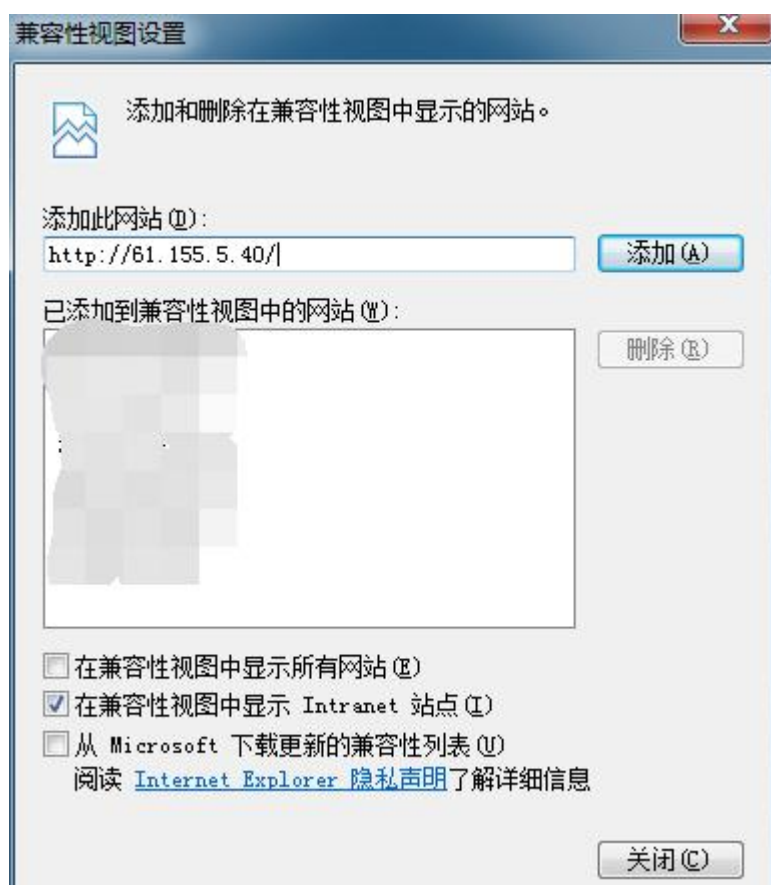

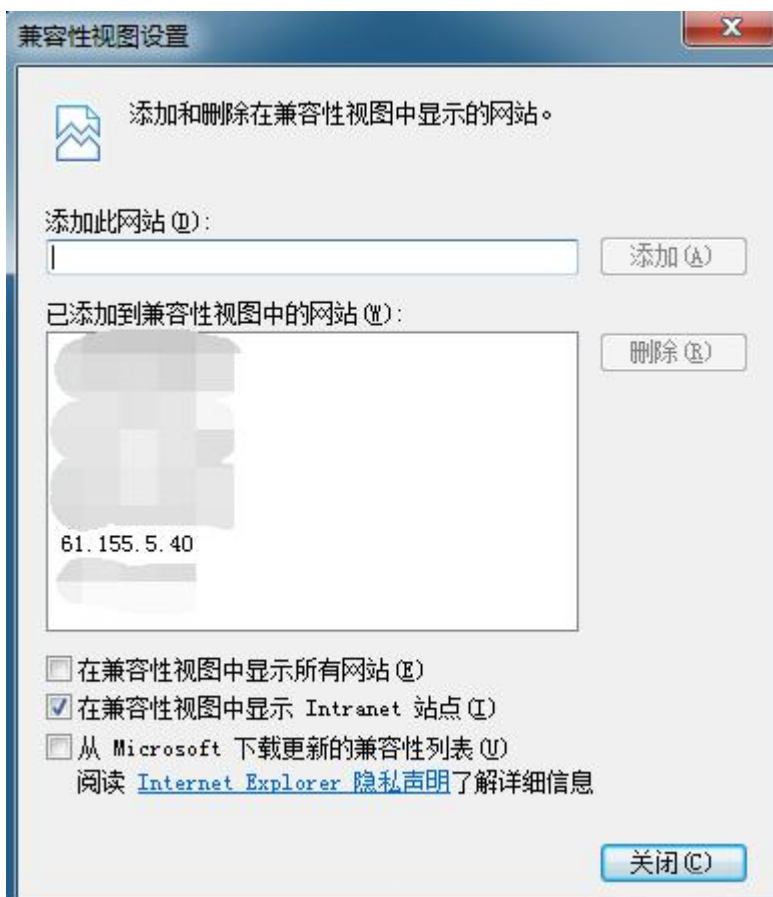

结 束

附件 2

适用条件 3 产品填报操作手册

1. 填报采购价格每页填完后，翻下一页前，必须点[保存]按钮，否则翻页后，刚才填写的信息就丢失了。

结束时间之前，可以修改已填报的价格，再次保存即可覆盖之前价格。

结束后，[保存]按钮就没有了，不能再填写价格。

2. 医院填写的价格可以精确到小数点后 4 位，请用半角格式下数字方式输入价格。

3. 请注意计量单位，所报价格必须是表中对应计量单位的价格，不一定是医院习惯的计价单位。

4. 骨科创伤、关节和脊柱类植入物，请区分产品材质（不锈钢、钛合金、纯钛），相同产品、相同规格型号情况下，因材质不同而有较大价格差异。

5. 医院界面有[导出]功能，可以导出所有信息，包括已填报的内容，方便核对。

6. 用账号密码登录网址：<http://61.155.5.40/ycpricecoll>
出现界面



7. 然后进入菜单栏价格采集点击下面医院价格采集点击操作进入:



8. 然后显示：已上报采购价指：2018年1月份或者4月份医疗机构已上报的采购价)；**医疗机构在商品最小计量单位价格里面填报商品最小计量单位采购价。**




每页填完后，翻下一页前，必须点[保存]按钮，否则翻页后，刚才填写的信息就丢失了，状态可以选择：“已操作或未操作”查看情况。

IE 浏览器设置


一、打开浏览器，点击工具—Internet 选项 (如下图所示)




二、选择标签里的安全，选择受信任的站点，点击站点按钮。
(如下图所示)

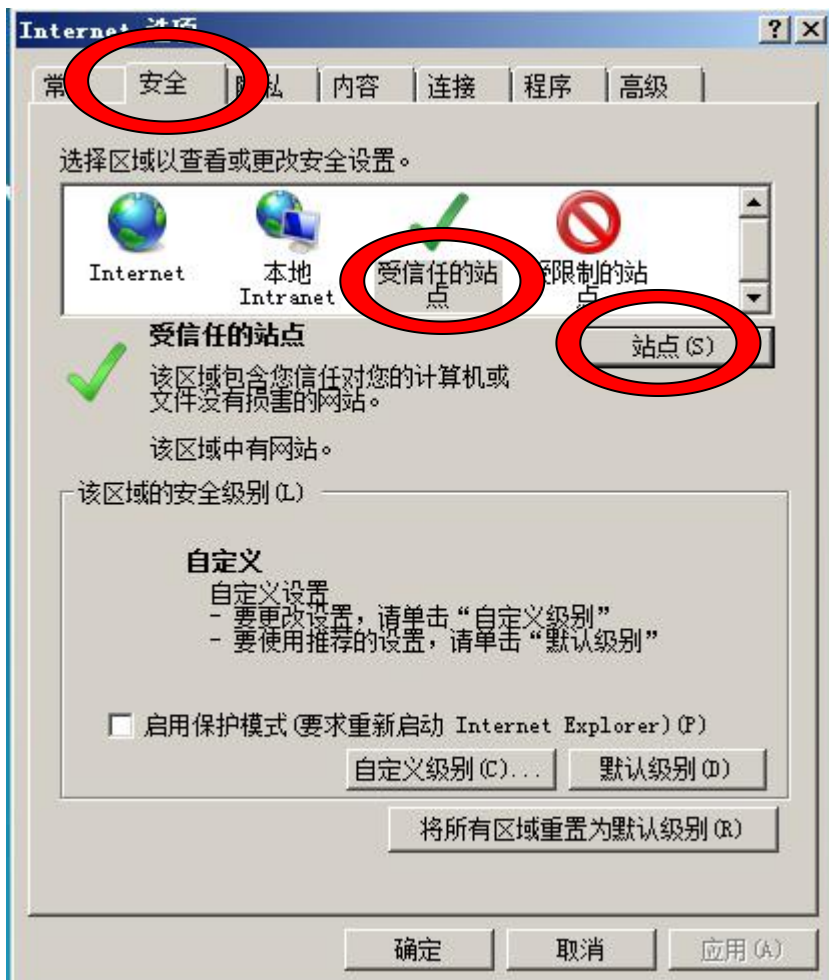

三、弹出受信任的站点对话框，在文本框中输入 <http://61.155.5.40/>，点击添加，这里注意下面的勾不能勾选(如下图所示)。关闭对话框。

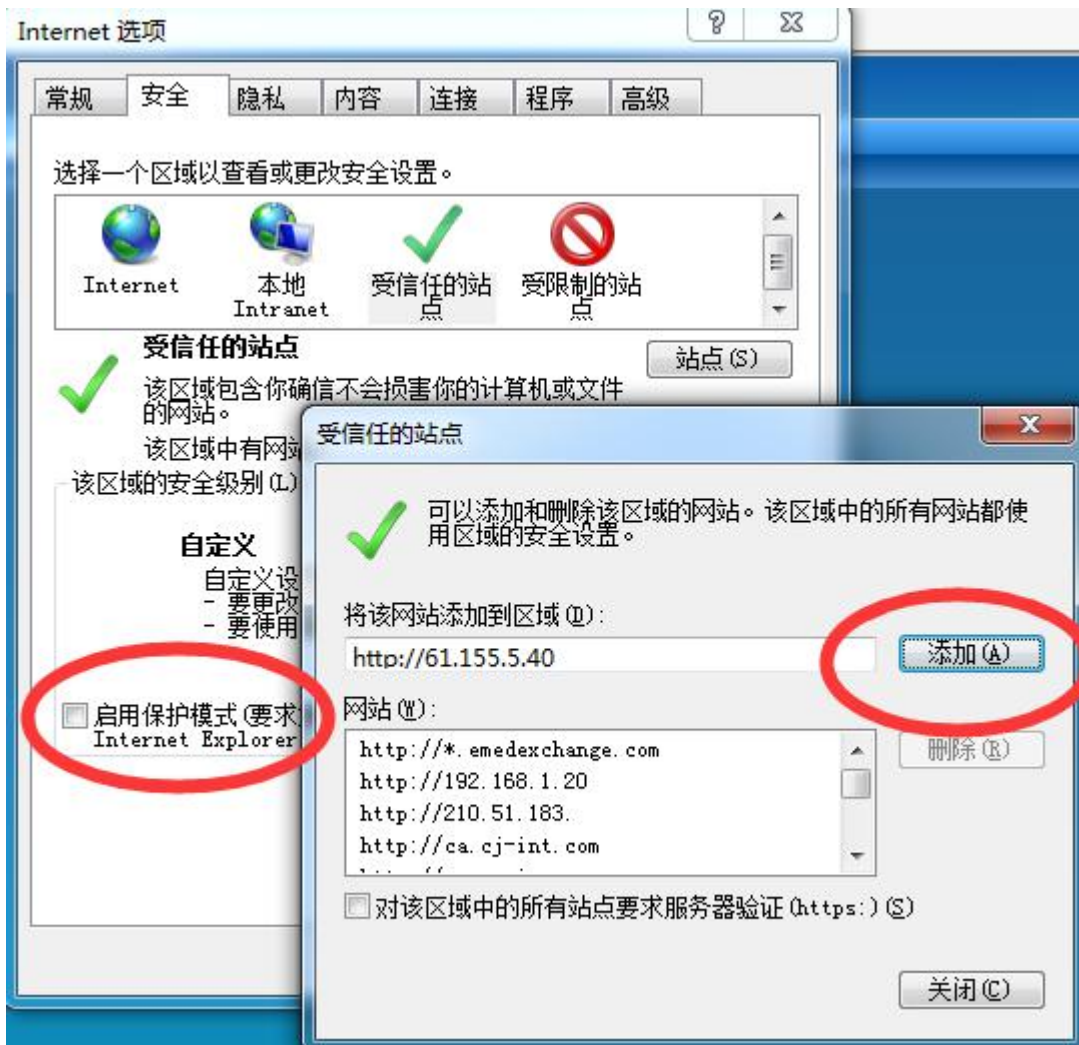


四、点击 Internet 选项对话框上的自定义级别按钮，弹出安全设置对话框，把带有 activex 的选项都设为启用。点击确定按钮保存修改。关闭所有对话框。把所有浏览器关闭。重新打开即可

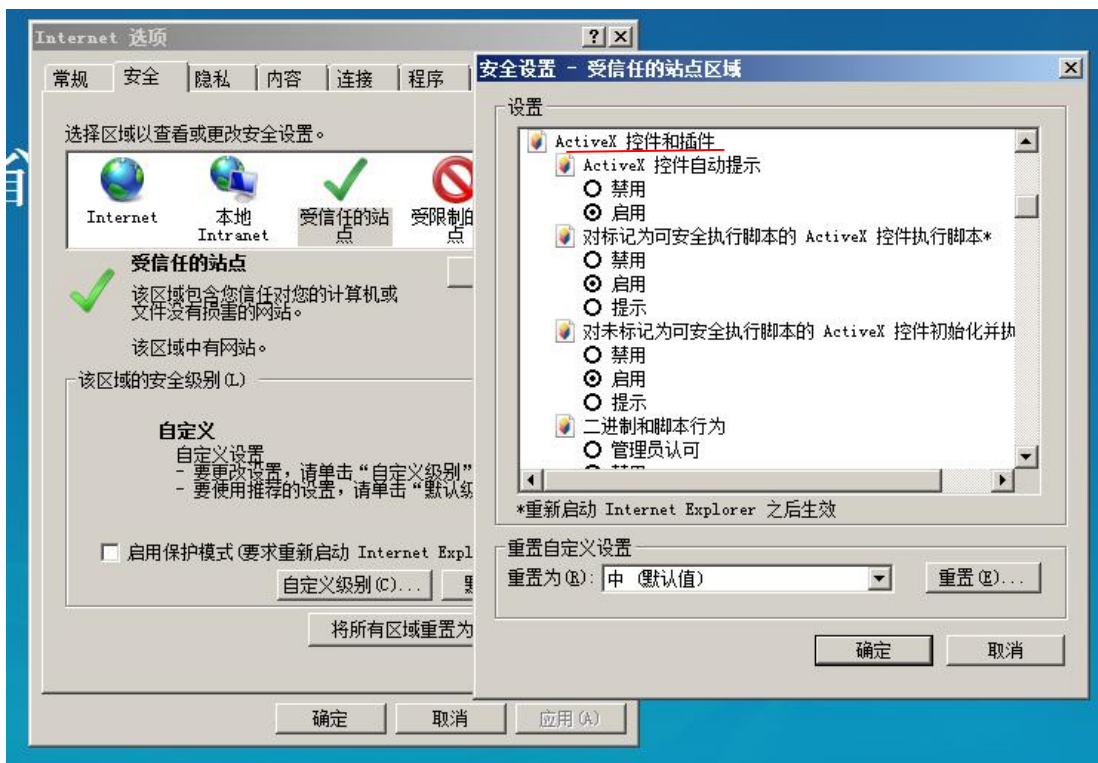

IE 兼容性视图设置

对于 IE 版本超过 6 的浏览器，需要设置兼容性视图。不设置会导致页面显示混乱。

1. 在 IE 的地址栏下的灰色空白区域右击鼠标，弹出菜单，“菜单栏”勾选上，然后在地址栏下面就会显示相关的菜单。

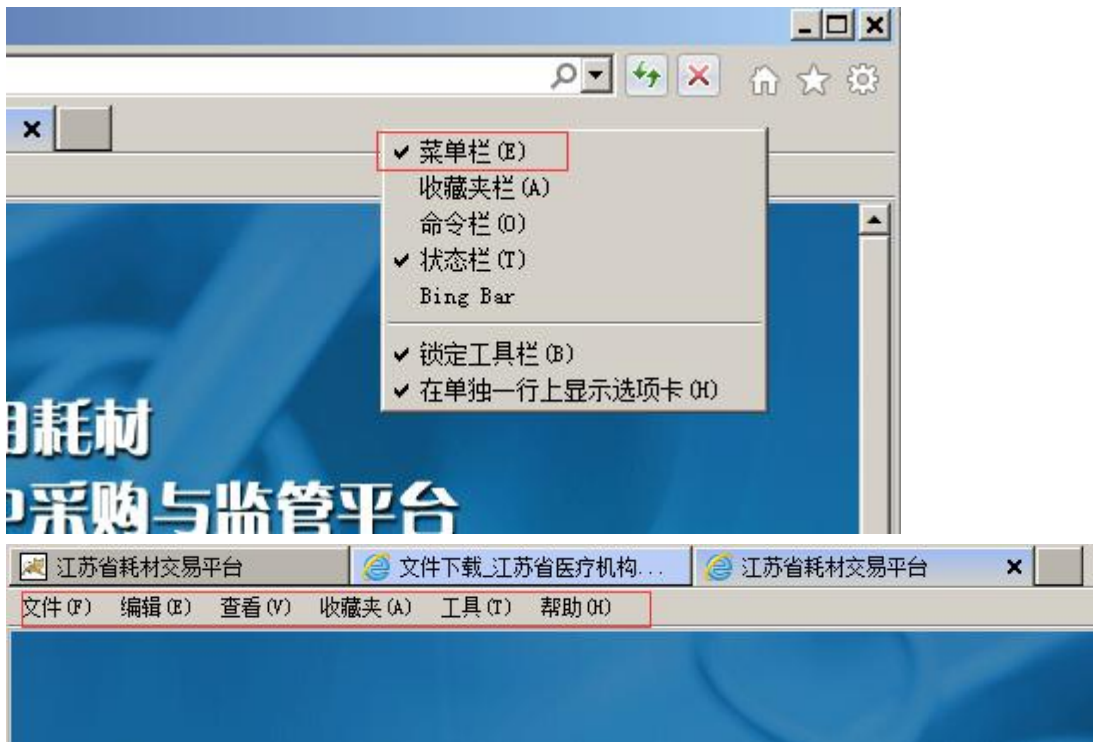


2. 点击菜单“工具”，选择菜单“兼容性视图设置”，如下图



3. 弹出框如下图，点击按钮“添加”把当前的地址添加到下面的列表中。



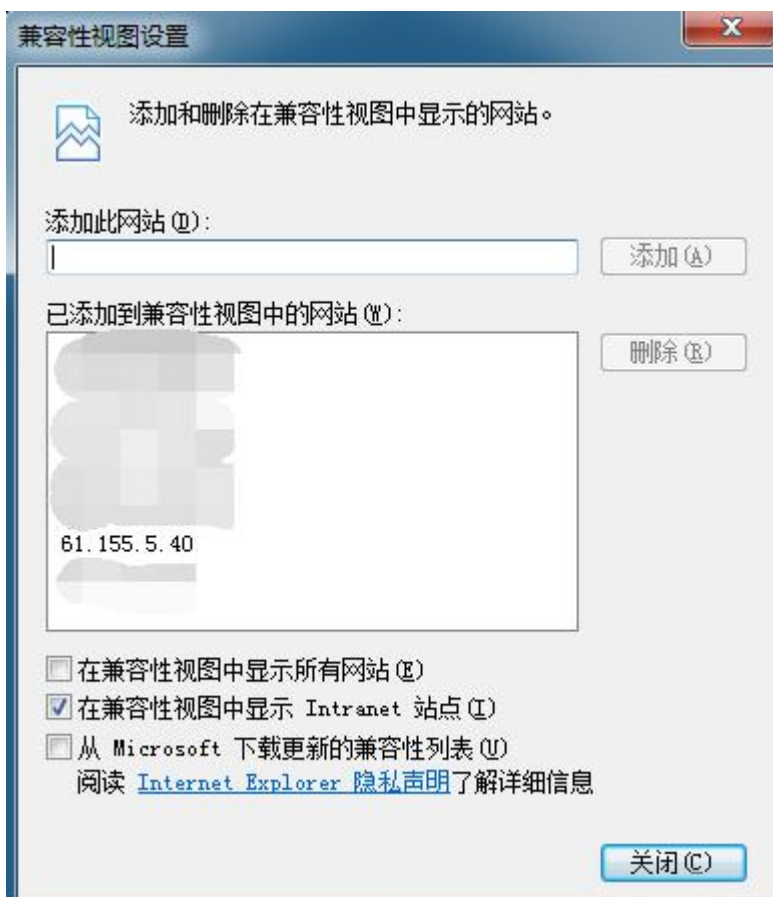

抄送：市药品（医用耗材）集中采购工作领导小组各成员单位。

盐城市药品（医用耗材）集中采购工作领导小组办公室 2019年9月20日印发
